

動物用X線撮影装置 T-MAX LITE

X線撮影装置 仕様


定格	100kV／50mA／4mAs
発生器	インバータ制御システム
管電圧範囲	40kV～110kV(1kVステップ可変)
管電流範囲	20mA～120mA
mAs範囲	0.3mAs～20mAs
X線管	焦点寸法 1.5mm
可動絞り(SID 1000mm) LED	最大 430×430mm

X線撮影台 仕様

	撮影台一体型	セパレート型
天板寸法	1200×600mm	—
天板長手ストローク	左右200mm	—
天板高さ	800mm(床面から天板面)	—
操作パネル取付	左右取付可能 上下左右調節可能アーム式	—
撮影台電源	AC100V 50/60Hz	—
本体重量	113kg	—

薬事承認番号：農林水産省指令元動薬第1937号

寸法図

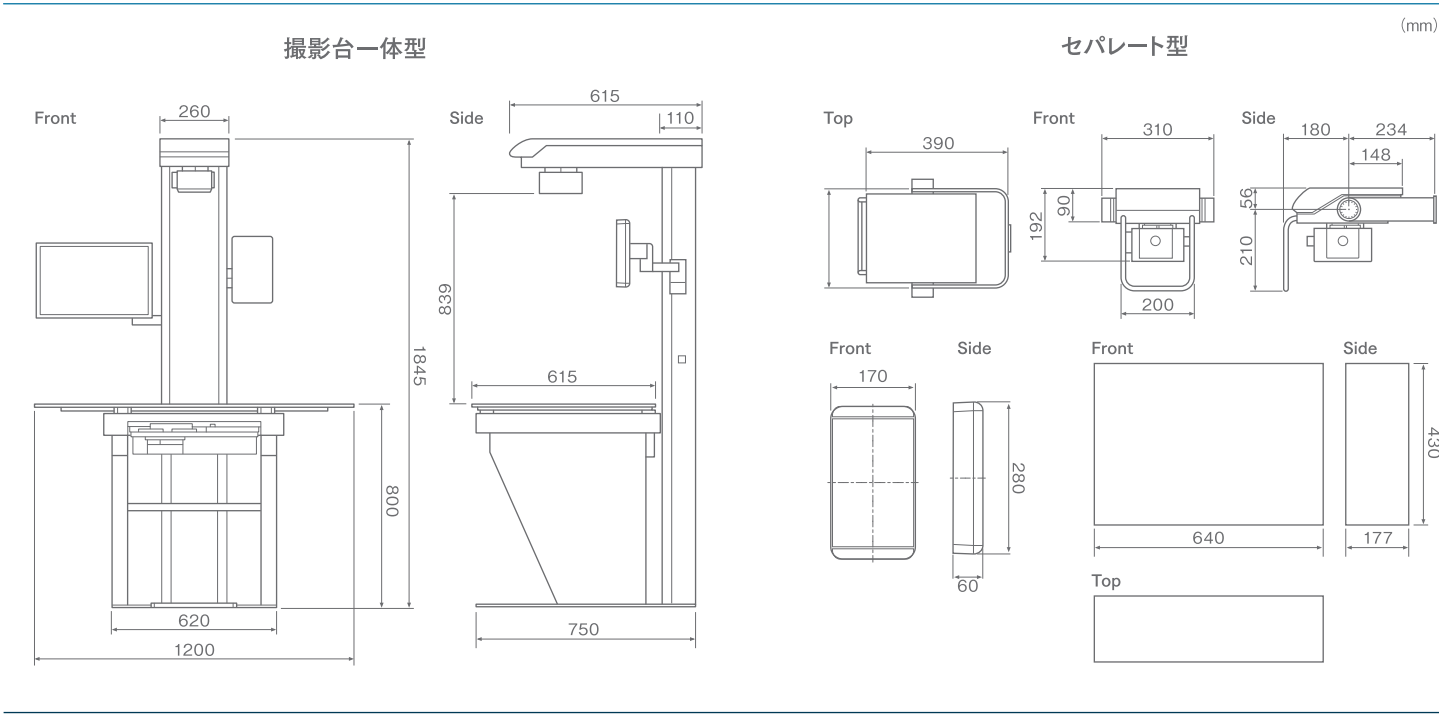

総販売元



動物医療のトータルネットワーク
株式会社 ヒューベス

TEL:04-2935-7644 FAX:04-2935-7645

E-mail:info@huves.co.jp https://www.huves.co.jp

〒350-1317 埼玉県狭山市水野432-4

製造元
開発元



株式会社 ティーアンドエス

医療機器製造業 許可番号 12BZ005025
第二種医療機器製造販売業 許可番号 12B2X00022
第二種動物用医療機器製造販売業許可番号 30製販療Ⅱ第48号





動物用X線撮影装置 T-MAX LITE

操作も診断もシンプルに
シンプルで直感的な操作性



進化するT-MAX LITE

- 犬・猫・鳥の撮影が可能
- 40kV～110kV(1kVステップ)の高出力
- 100V電源で、どこでも設置可能
- 20mA～120mA(kV連動による自動設定)
- 0.3mAs～20mAsまで可能
- 自動設定の他、マニュアルでkVとmAsの調整が可能

- 面積線量表示機能を標準搭載


使いやすいコンソールパネル

撮影条件は4種類の設定で簡単

被写体 体重 部位 方向



撮影台一体型

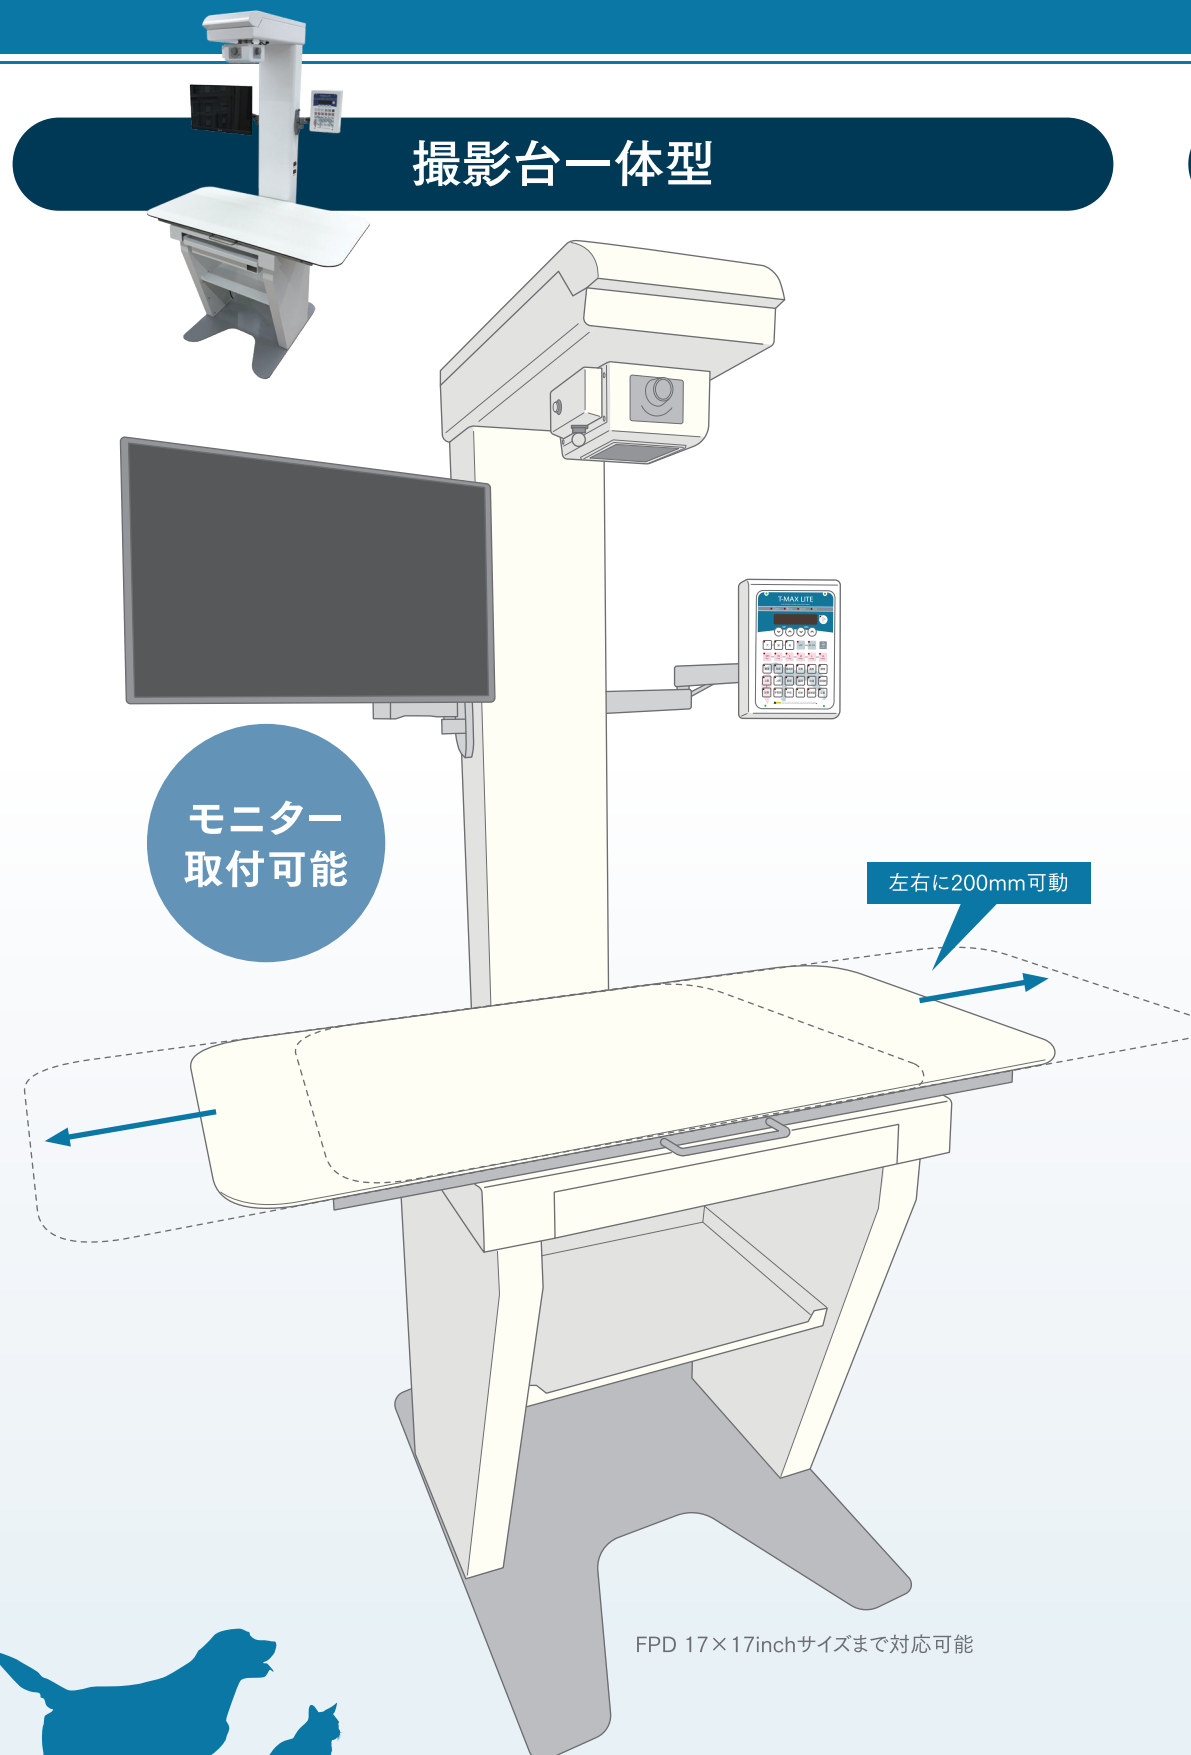

セパレート型

