


動画撮影を実現する 動物用 FPD1717F

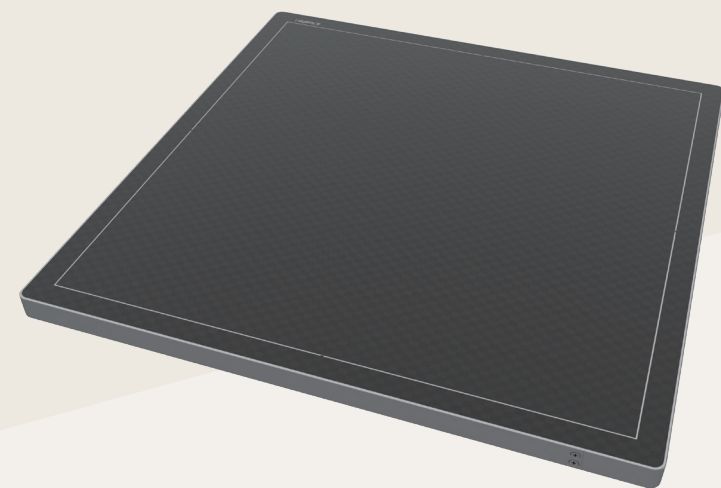


特長

1 フラットパネルで動画撮影

FPDによる高解像度の透視画像を鮮明に映し出し、スムーズな透視撮影が可能。診断の正確性が向上し、動物への負担を最小限に抑えます。

2 動画撮影中にリアルタイム画質調整

撮影中に明るさとコントラストを自由に調整可能。画像診断の向上に繋がります。

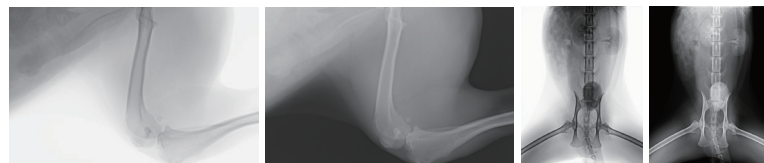

3 透視スナップショット


最先端技術を駆使し、保存動画の確認中に重要な瞬間をスナップショット保存。DICOM形式でキャプチャーします。

動きによるブレを最小限に、今まで見えなかった四隅まで撮影可能に

高速フレームレート

MAX.30fps

広い撮影可能領域

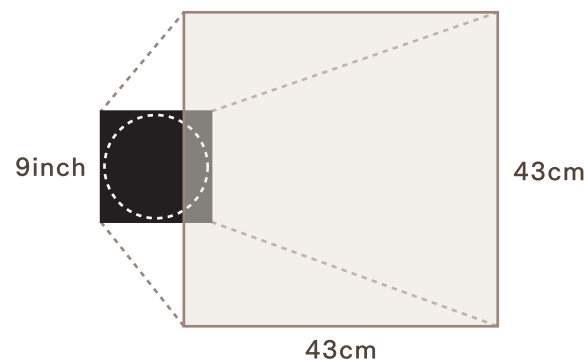

総販売元
 動物医療のトータルネットワーク
株式会社 **ヒューベス**
TEL: **04-2935-7644** FAX: **04-2935-7645**
E-mail: **info@huves.co.jp**
〒350-1317 埼玉県狭山市水野432-4
<https://www.huves.co.jp>

製造元・開発元
 **株式会社 ティーアンドエス**
医療機器製造業 許可番号 12BZ005025
第二種医療機器製造販売業 許可番号 12B2X00022
第二種動物用医療機器製造販売業許可番号 30製販療Ⅱ第48号



株式会社ティエントエスは、品質マネジメントシステム規格ISO9001:2015、環境マネジメントシステム規格ISO14001:2015、医療機器の品質マネジメントシステム規格ISO13485:2016に適合する、医療機器メーカーとしてBUREAU VERITASによって認証されています。

- 記載されている内容、外観及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
 - カタログの写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
- ※当カタログの内容は、無断転載を禁じます。

動物用X線透視システム

T-MAX 32R

動物用 FPD1717F

動物の動きを逃さず捉える
ダイナミックな“動画撮影”を実現

